



Kalibrierung mit Einstellring 0641-31  
(im Lieferumfang enthalten)



Auflagepunkt (3x)

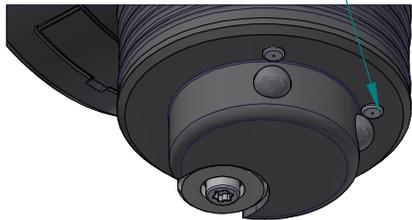

punktuelle Messung  
am gesamten Rollrand  
durch 3 Auflagepunkte

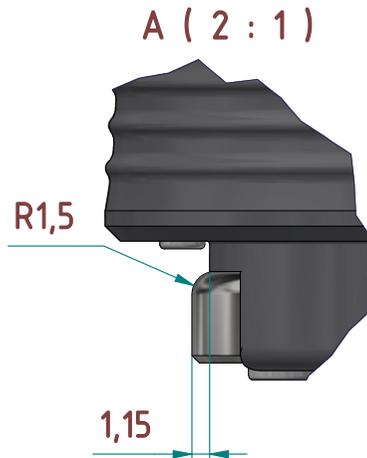

technische Änderungen vorbehalten

**Serie:** Aerosol  
**Messbereich:** 3,5 - 5,0 mm  
**Anzeigebereich:** 3,1 - 10,2 mm  
**Zifferschrittwert:** 0,01 mm  
**Skalenteilungswert:** -  
**Messkraft:** 2,0 - 3,0 N (im Messbereich)  
**Gerätgewicht:** 350 g

(Zulässige Abweichungen nach VDI/VDE/DGQ 2618 Bl. 12.1/13.1)

**Fehlergrenze "G":** 0,02 mm  
**Wiederholgrenze "r":** 0,02 mm

**Bezugstemperatur:** 20° C  
**Betriebstemperatur:** 10° C - 30° C  
**Lagertemperatur:** -10° C - 50° C

**Maßstab:** 1:1  
**Zeichnung-Nr.:** IDW-AE2130-DB  
**Erstelldatum:** 20.03.2015  
**Bearbeiter:** J.Röder  
**Änderungsstand:** 2301 (BSc)  
**Änderungsdatum:** 17.05.2023

4

3

2

1

AE2130

Kalibrierung


Messung

D

C

B

A

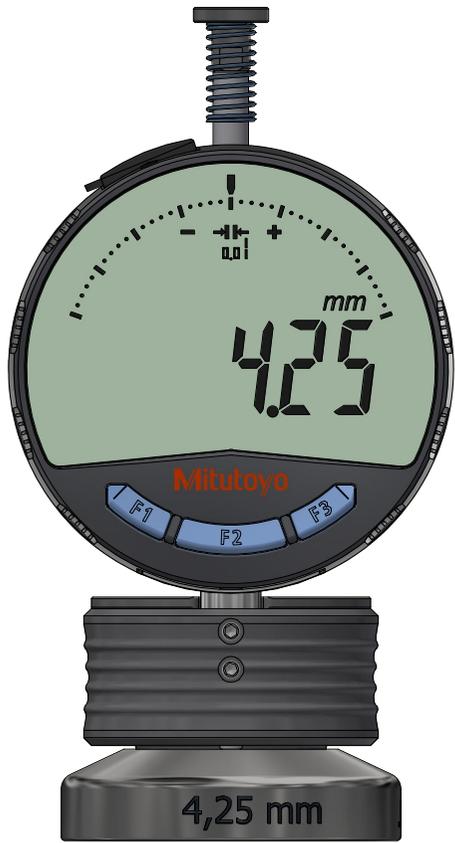

B ( 2 : 1 )

C ( 2 : 1 )

